Щелочная фосфатаза

DGKC-1970 (п-нитрофенольный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E (монореагент)

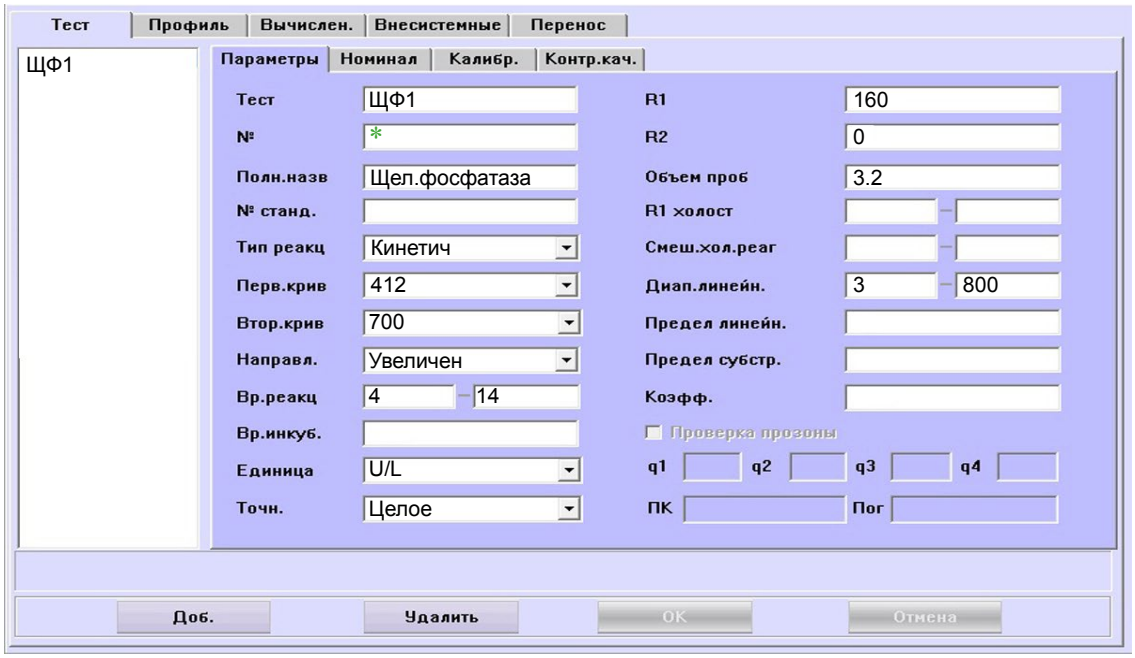

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

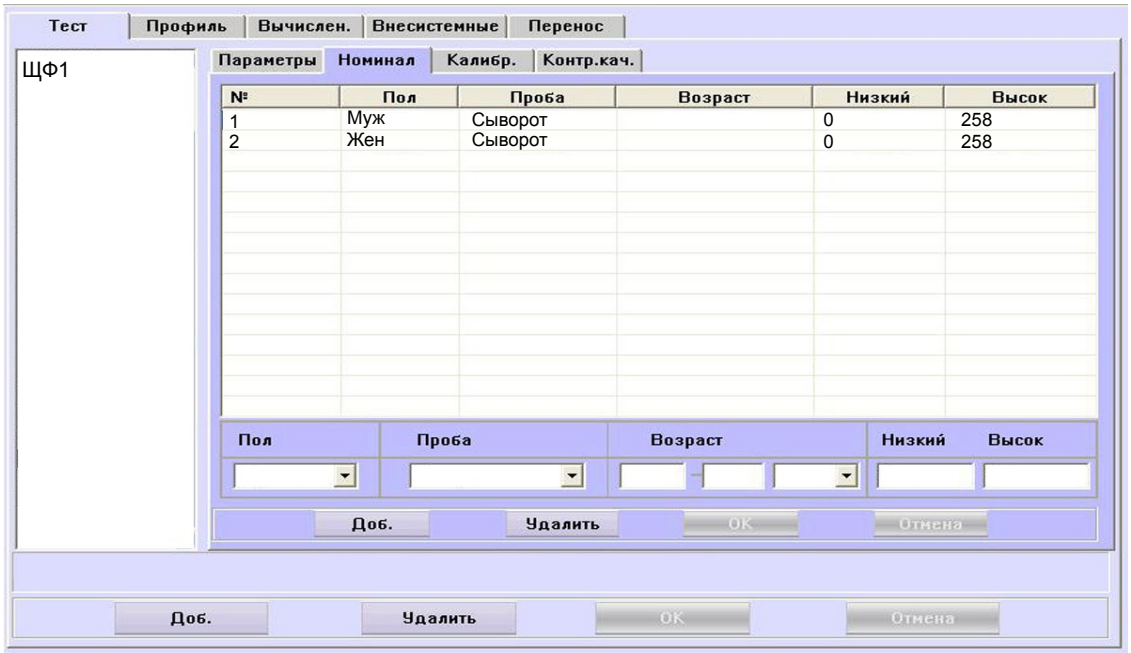

Тел.: (495) 980-63-39
Факс: (495) 980-66-79
e-mail: sale@diakonlab.ru
сайт: www.diakonlab.ru

Щелочная фосфатаза

DGKC-1970 (п-нитрофенольный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E (монореагент)

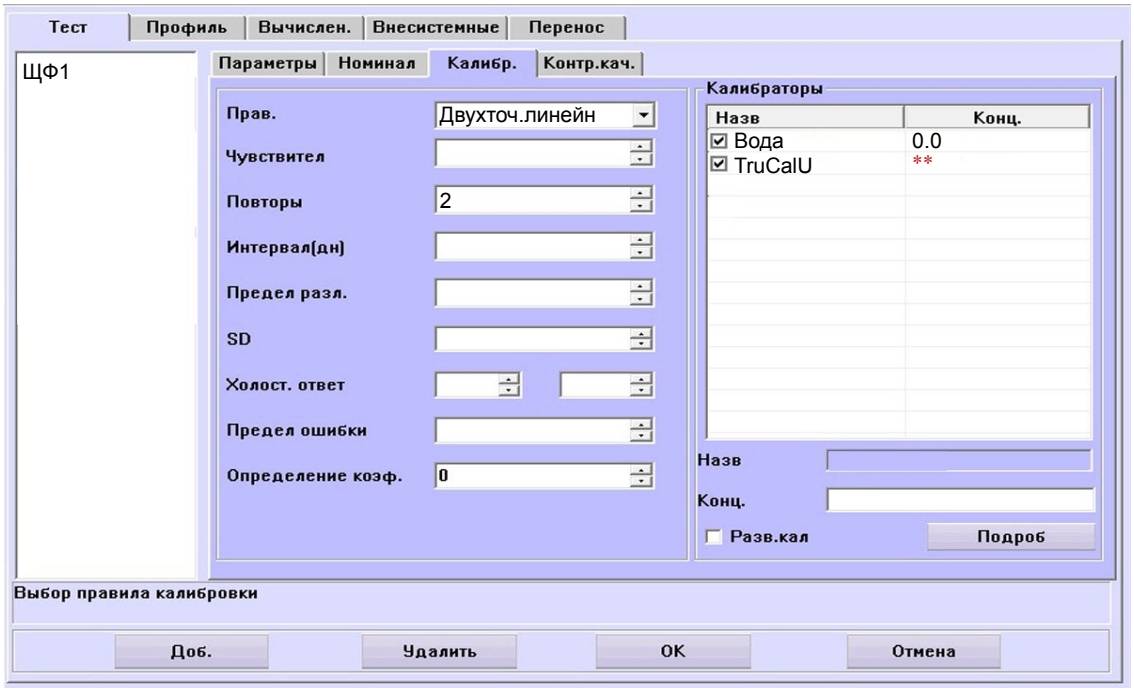

**-вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тел.: (495) 980-63-39
Факс: (495) 980-66-79
e-mail: sale@diakonlab.ru
сайт: www.diakonlab.ru