


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

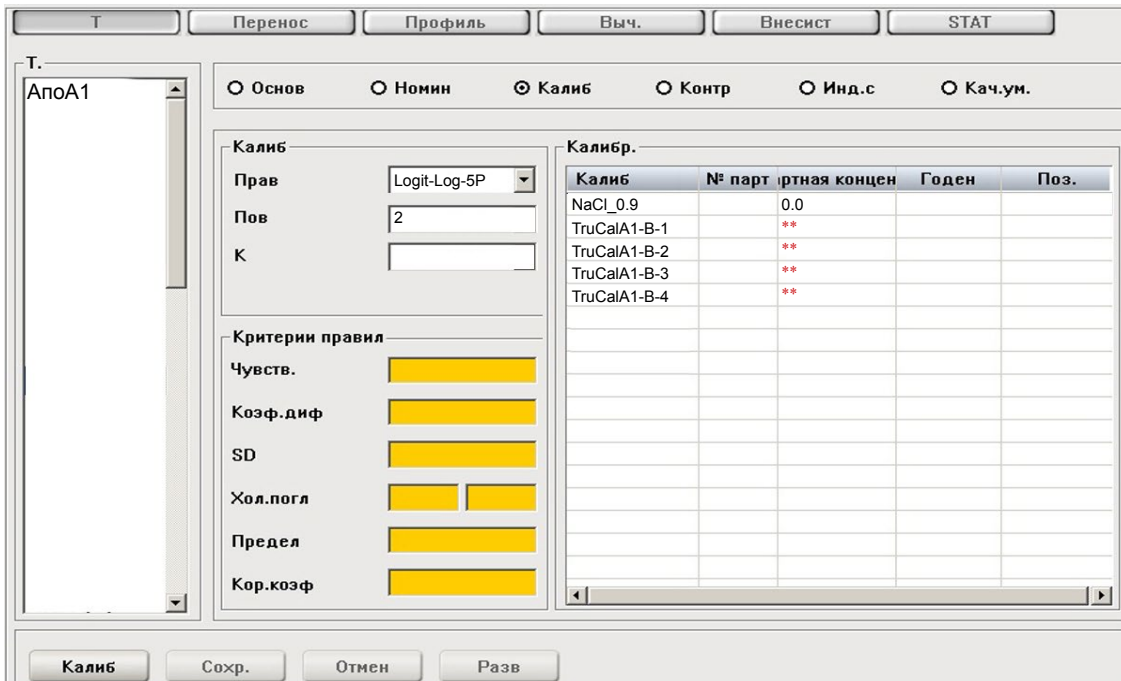

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalA1-B-1		**		
TruCalA1-B-2		**		
TruCalA1-B-3		**		
TruCalA1-B-4		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр. кач.» соответственно.