Щелочная фосфатаза

DGKC-1970 (п-нитрофенольный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ЩФ

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Тест	ЩФ	R1	160
№	*	R2	40
Полн.назв	Щел.фосфатаза	Объем проб	3.2
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кинетич	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	412	Диап.линейн.	3 – 800
Втор.крив	700	Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	4 – 14	Коэфф.	
Вр.инкуб.	12	Проверка прозоны	
Единица	U/L	q1 q2 q3 q4	
Точн.	Целое	ПК Пог	

Доб. | Удалить | OK | Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ЩФ

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	258
2	Жен	Сыворот		0	258

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Доб. | Удалить | OK | Отмена

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79 сайт: www.diakonlab.ru

Щелочная фосфатаза

DGKC-1970 (п-нитрофенольный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

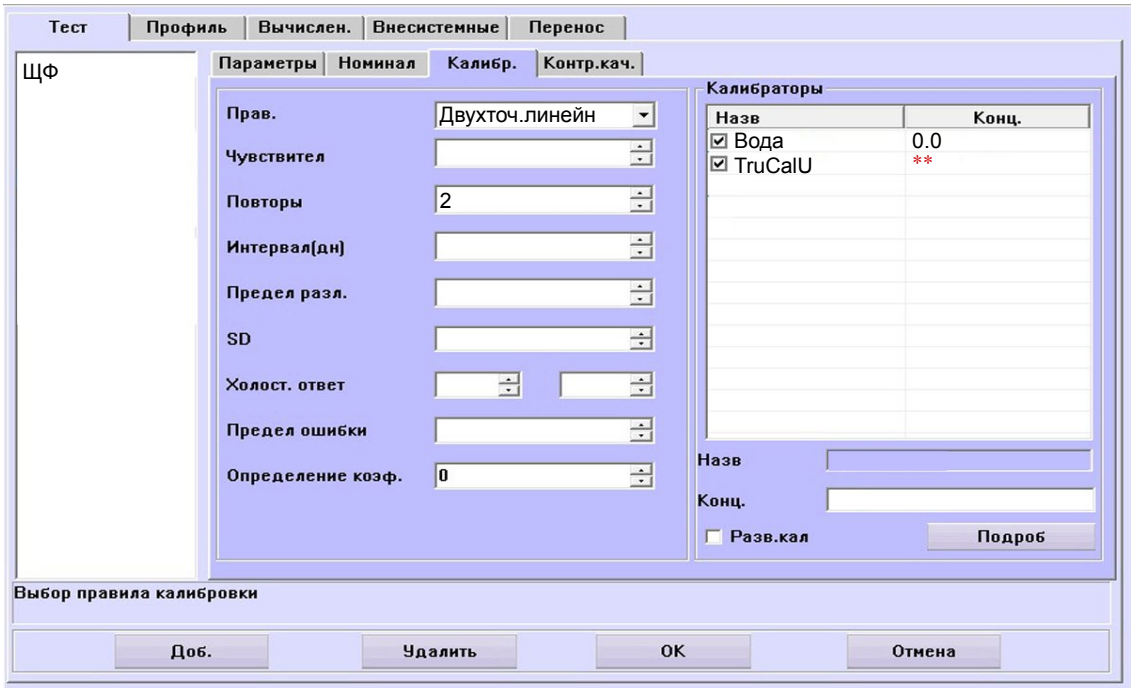

**-вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тел.: (495) 980-63-39 e-mail: sale@diakonlab.ru
Факс: (495) 980-66-79 сайт: www.diakonlab.ru